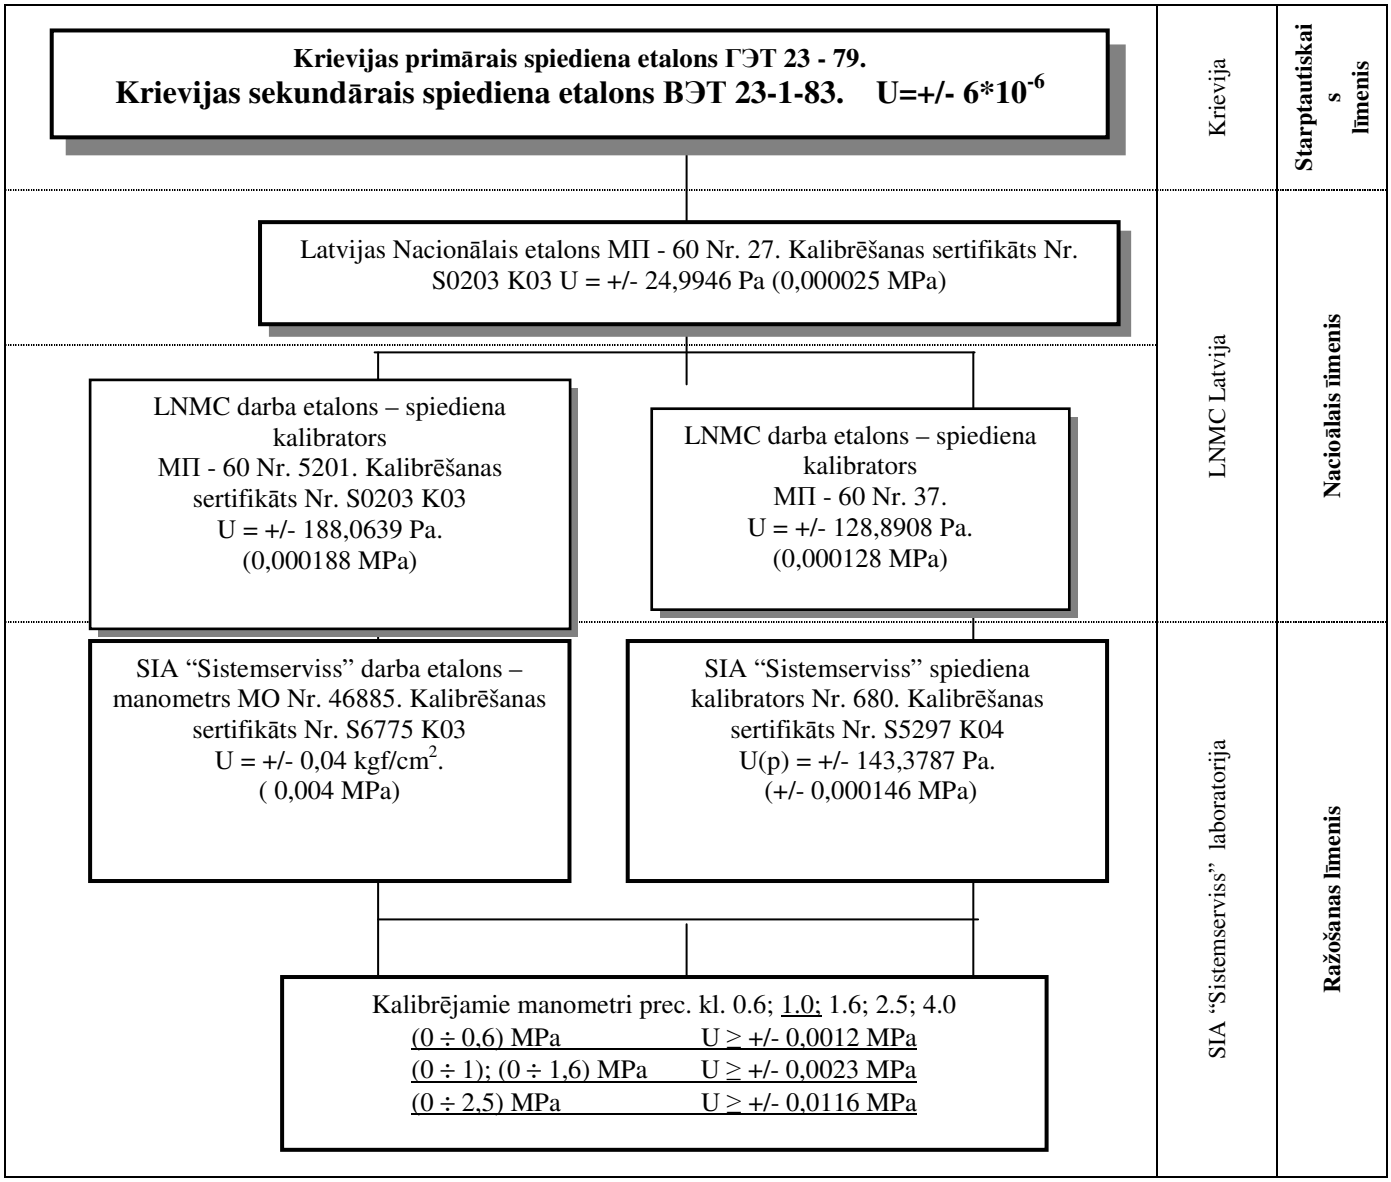
Krievijas primārais spiediena etalons ГЭТ 23 - 79.
Krievijas sekundārais spiediena etalons ВЭТ 23-1-83. U=+/- 6*10-6
Krievija
Starptautiskais līmenis
Latvijas Nacionālais etalons МП - 60 Nr. 27. Kalibrēšanas sertifikāts Nr. S0203 K03 U = +/- 24,9946 Pa (0,000025 MPa)
LNMC darba etalons – spiediena kalibrators МП - 60 Nr. 5201. Kalibrēšanas sertifikāts Nr. S0203 K03 U = +/- 188,0639 Pa. (0,000188 MPa)
LNMC darba etalons – spiediena kalibrators МП - 60 Nr. 37. U = +/- 128,8908 Pa. (0,000128 MPa)
LNMC Latvija
Nacioālais līmenis
SIA "Sistemserviss" darba etalons – manometrs MO Nr. 46885. Kalibrēšanas sertifikāts Nr. S6775 K03 U = +/- 0,04 kgf/cm2. (0,004 MPa)
SIA "Sistemserviss" spiediena kalibrators Nr. 680. Kalibrēšanas sertifikāts Nr. S5297 K04 U(p) = +/- 143,3787 Pa. (+/- 0,000146 MPa)
Kalibrējamie manometri prec. kl. 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0
(0 ÷ 0,6) MPa U ≥ +/- 0,0012 MPa
(0 ÷ 1); (0 ÷ 1,6) MPa U ≥ +/- 0,0023 MPa
(0 ÷ 2,5) MPa U ≥ +/- 0,0116 MPa
SIA "Sistemserviss" laboratorija
Ražošanas līmenis